


**INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS
DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA No. IA-66-023-907049991-N-5-2024**

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "CHIAPAS 3" DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES UBICADA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "C" COLONIA MAYA C.P. 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, LA C.P. **SUSANA MAGDALENA RUÍZ LÓPEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Y EL **DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ÁREA REQUERENTE DEL INSTITUTO DE SALUD**; CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA Y AL PUNTO 4.2 DE LAS BASES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA DE PARTICIPACIÓN PRESENCIAL No. IA-66-023-907049991-N-5-2024**; PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024) DEL INSTITUTO DE SALUD, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.

JONATHAN LEYBER DÍAZ DE LOS SANTOS (PERSONA FÍSICA)	RESPUESTAS
PREGUNTAS	
<p><u>Punto K2, Ficha Técnica. Página: 33,35</u> se solicita a la convocante nos aclare respecto al lote 18; que a la letra dice: servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, calificación y calibración a equipos complementarios que incluyen: mantenimiento preventivo a agitador rotatorio Fisher consistente en limpieza general del equipo, lubricación de las partes mecánicas, revisión del sistema eléctrico, revisión del motor eléctrico, verificación de perillas de rpm y del temporizador. realizar calibración en 60, 100, 140, 180, 210 RPMS por una empresa acreditada ante la EMA. Mantenimiento preventivo de microscopio binocular del área de Inmunofluorescencia marca CARL ZEISS. consistente en: limpieza general del equipo, limpieza del sistema óptico (oculares, tubo binocular, objetivos, condensador y diafragma de campo) revisión y lubricación del sistema mecánico, revisión y ajuste del sistema eléctrico y técnica de Kholer, calibración a centrifuga de mesa (muestreos), marca HETTICH, modelo: Rotofix 32-a. consistente en calibración en un punto a 3000 rpms, por una empresa acreditada ante la EMA. calibración a centrifuga marca DLAB, modelo: d3024r., consistente en calibración en dos puntos: 8000 y 14000 rpms a 4°C, por una empresa acreditada ante la EMA. Calibración a centrifuga marca Beckman coulter, modelo: ALLEGRA x-12r, consistente en calibración en dos puntos: 1500 y 2500 rpms, por una</p>	<p>Es correcto, deberá considerar el servicio descrito para cada equipo en el lote 18</p>


**INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

empresa acreditada ante la EMA. calificación a equipo ultracongelador marca Thermo scientific, modelo tsx40086a, consistente en calificación en un punto a -70 °c, por una empresa acreditada ante la EMA. calificación a equipo ultracongelador marca Thermo scientific, modelo 8700, consistente en calificación en un punto a -70 °c, por una empresa acreditada ante la ema. calificación a equipo ultracongelador marca Thermo scientific, modelo tsx400864, consistente en calificación en un punto a -70 °c, por una empresa acreditada ante la EMA. calibración a microcentrifuga marca Thermo scientific modelo: Heraeus pico 21, consistente en calibración en un punto a 5500 rpms por una empresa acreditada ante la EMA. calificación a equipo ultracongelador marca Thermo scientific, modelo 8700, consistente en calificación en un punto a -70 °c, por una empresa acreditada ante la EMA.

Pregunta no. 1: ¿Favor de indicar, si los equipos a los cuales se les dará el servicio de mantenimiento son todos los indicados en el lote 18?

Pregunta no. 2: Se observó en el lote 18 que la descripción cuenta con diversos equipos, los cuales no son muy específicos. Se le pide a la convocante enliste los equipos especificando los servicios que corresponde a cada uno del lote 18, debido a que la información es confusa.

Los servicios requeridos para cada equipo incluido en el lote 18 son:

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR ROTATORIO FISHER CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO, VERIFICACIÓN DE PERILLAS DE RPM Y DEL TEMPORIZADOR. REALIZAR CALIBRACIÓN EN 60, 100, 140, 180, 210 RPMS POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.**
- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR DEL ÁREA DE INMUNOFLUORESCENCIA MARCA CARL ZEISS. CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, TUBO BINOCULAR, OBJETIVOS, CONDENSADOR Y DIAFRAGMA DE CAMPO) REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TÉCNICA DE KÖHLER.**
- **CALIBRACIÓN A CENTRIFUGA DE MESA (MUESTREOS), MARCA HETTICH, MODELO: ROTOFIX 32-A. CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN UN PUNTO A 3000 RPMS, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.**

INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

	<ul style="list-style-type: none"> • CALIBRACIÓN A CENTRIFUGA MARCA DLAB, MODELO: D3024R, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN DOS PUNTOS: 8000 Y 14000 RPMS A 4°C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA. • CALIBRACIÓN A CENTRIFUGA MARCA BECKMAN COULTER, MODELO: ALLEGRA X-12R, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN DOS PUNTOS: 1500 Y 2500 RPMS, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA. • CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TSX40086A, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA • CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 8700, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA. • CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TSX400864, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA. • CALIBRACIÓN A MICROCENTRIFUGA MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO: HERAEUS PICO 21, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN UN PUNTO A 5500 RPMS POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA. • CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 8700, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.
<p>Pregunta no. 3: Si la convocante acepta enlistar los equipos del lote 18, solicitamos nos permita enlistarlos dentro del anexo Técnico términos de referencia del lote 18, anexo a la Ficha Técnica.</p>	<p>Se Acepta, sin embargo, en su propuesta técnica deberá describir el servicio de acuerdo a la descripción solicitada</p>
<p>Pregunta no. 4: Se solicita a la convocante, especifique cuales son los equipos del lote 18, que requieren mantenimiento correctivo.</p>	<p>Los servicios requeridos para cada equipo incluido en el lote 18 son los que se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u> A AGITADOR ROTATORIO FISHER CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS, REVISIÓN DEL

INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO, VERIFICACIÓN DE PERILLAS DE RPM Y DEL TEMPORIZADOR. REALIZAR CALIBRACIÓN EN 60, 100, 140, 180, 210 RPMS POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR DEL ÁREA DE INMUNOFLUORESCENCIA MARCA CARL ZEISS. CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, TUBO BINOCULAR, OBJETIVOS, CONDENSADOR Y DIAFRAGMA DE CAMPO) REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TÉCNICA DE KÖHLER.
- CALIBRACIÓN A CENTRIFUGA DE MESA (MUESTREOS), MARCA HETTICH, MODELO: ROTOFIX 32-A. CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN UN PUNTO A 3000 RPMS, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.
- CALIBRACIÓN A CENTRIFUGA MARCA DLAB, MODELO: D3024R, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN DOS PUNTOS: 8000 Y 14000 RPMS A 4°C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.
- CALIBRACIÓN A CENTRIFUGA MARCA BECKMAN COULTER, MODELO: ALLEGRA X-12R, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN DOS PUNTOS: 1500 Y 2500 RPMS, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.
- CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TSX40086A, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA
- CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 8700, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.
- CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TSX400864, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA.

**INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

	<ul style="list-style-type: none"> • CALIBRACIÓN A MICROCENTRIFUGA MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO: HERAEUS PICO 21, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN EN UN PUNTO A 5500 RPMs POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA. • CALIFICACIÓN A EQUIPO ULTRACONGELADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 8700, CONSISTENTE EN CALIFICACIÓN EN UN PUNTO A -70 °C, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA. <p>Los equipos considerados se encuentran en operación actualmente en el Laboratorio Estatal, y los servicios solicitados son mantenimiento preventivo y servicios de calibración y calificación.</p>
<p>Pregunta no. 5: De acuerdo a la pregunta 4, favor de indicar las fallas con las que cuentan los equipos a los que se les dará mantenimiento correctivo, para poder cotizar los servicios de mantenimiento.</p>	<p>Los equipos considerados se encuentran en operación actualmente en el Laboratorio Estatal, los servicios solicitados son de carácter preventivo, calibración y calificación; sin embargo, los ofertantes podrán acudir, previa cita, a las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud Pública de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas para conocer el estado de los equipos para una mejor integración de sus propuestas, evidenciando dicha visita previa a su oferta técnica, con carta emitida por el Laboratorio Estatal.</p>
<p><u>Punto K2, Ficha Técnica.</u> Página 35 Garantías: Pregunta no. 6: ¿Favor de indicar si las dos especificaciones de garantía que menciona dentro del formato de la ficha técnica, se deberán incluir por cartas separadas?</p>	<p>Si se acepta sin que esto sea motivo de descalificación.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

**INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

ACLARACIONES GENERALES

DICE

1.1. CONCEPTO:

ANEXO-	CONCEPTO	PROGRAMA	PARTIDA
02 A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024) DEL INSTITUTO DE SALUD	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024)	35401
02 B	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024) DEL INSTITUTO DE SALUD		53101

DEBE DECIR:

1.1 CONCEPTO:

ANEXO-	CONCEPTO	PROGRAMA	PARTIDA
02 A	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024) DEL INSTITUTO DE SALUD	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024)	53101
02 B	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024) DEL INSTITUTO DE SALUD		35401

DEL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA DICE:

(FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA)

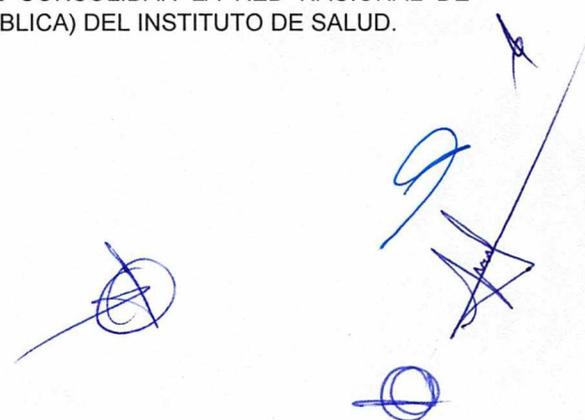
PUNTO K1 (02 A)

ORIGINAL DE LA FICHA TÉCNICA

A ___ DE _____ DEL 2024

**DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE SALUD.**

LOTE K1: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA EL CONSOLIDAR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA (LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA) DEL INSTITUTO DE SALUD.



**INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

DEBE DECIR:

(FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA)

PUNTO K1 (02 A)

ORIGINAL DE LA FICHA TÉCNICA

A ____ DE ____ DEL 2024

**DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE SALUD.**

LOTE K1: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 2024) DEL INSTITUTO DE SALUD.

NO SE RECIBIERON MAS PREGUNTAS O SOLICITUDES DE ACLARACIONES POR PARTE DE LOS INVITADOS A PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRANET, VÍA CORREO ELECTRÓNICO O DE MANERA PRESENCIAL, EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE ESTE CONCURSO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.


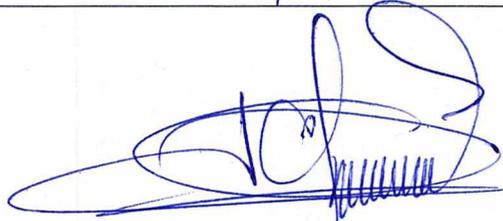
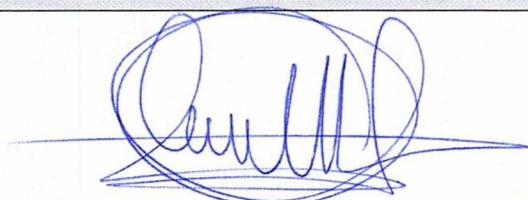
LAS ACTAS LAS PODRÁN OBTENER EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS UBICADA EN UBICADA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "C" COLONIA MAYA C.P. 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN HORARIO LABORAL Y A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: www.compranet.gob.mx, DE CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE LA FECHA DE **APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 13:00 HORAS** Y SE REALIZARÁ EN LA SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS UBICADA EN UBICADA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "C" COLONIA MAYA C.P. 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS SIENDO LAS 15:50 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

POR LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS.

<u>FUNCIONARIOS</u>	<u>FIRMA</u>
<p>C.P. SUSANA MAGDALENA RUÍZ LÓPEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	
<p>DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>	
<p>LIC. MARÍA SUJEI SÁNCHEZ CHEVEZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.</p>	
<p>C.P. GERARDO ESPINOSA CIFUENTES CONTRALOR INTERNO EN EL INSTITUTO DE SALUD REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.</p>	
<p>QFB. ADRIANA GÓMEZ BUSTAMANTE DIRECTORA DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA..</p>	
<p>REPRESENTANTES DEL ÁREA REQUIRENTE</p>	
<p>LIC. CESAR MIGUEL VÁZQUEZ MORALES VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SaNAS 20204)</p>	



**INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

POR LOS INVITADOS A PARTICIPAR

<u>INVITADOS</u>	<u>FIRMA</u>
<u>JONATHAN LEYBER DÍAZ DE LOS SANTOS</u> <u>(PERSONA FÍSICA)</u>	Celina Rivera Landaverde 

LAS SIGUIENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA NO. IA-66-023-907049991-N-5-2024 LLEVADA A CABO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024.

INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA No. IA-66-023-907049991-N-5-2024 LLEVADA A CABO A TRAVES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE SALUD; CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 A LAS 15:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

POR LOS INVITADOS A PARTICIPAR

<u>INVITADOS</u>	<u>FIRMA</u>
Jonathan Leyber Diaz de los Santos	Celina Rivera Landaverde 

